omnipod®

EROGAZIONE SEMPLICE E CONTINUA DI INSULINA PER LE PERSONE AFFETTE DA DIABETE CHE CREDONO CHE LA QUALITÀ DELLA VITA VENGA PRIMA DI TUTTO.

SISTEMA PER LA GESTIONE INSULINICA

Kishon K.
Podder™
DAL 2015

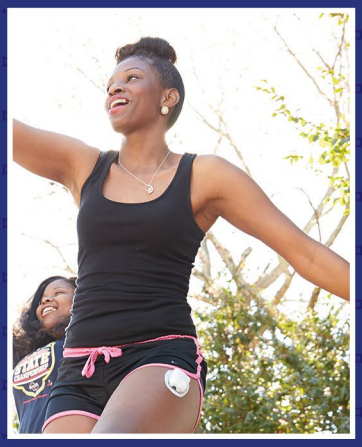

INSULINA CONTINUA* PER 3 GIORNI

*Fino a 72 ore di somministrazione continua di insulina

Sistema per la gestione insulinica Omnipod®

BROCHURE PER IL REFERENTE MEDICO

Nathaniel P.

Podder™

DAL 2014

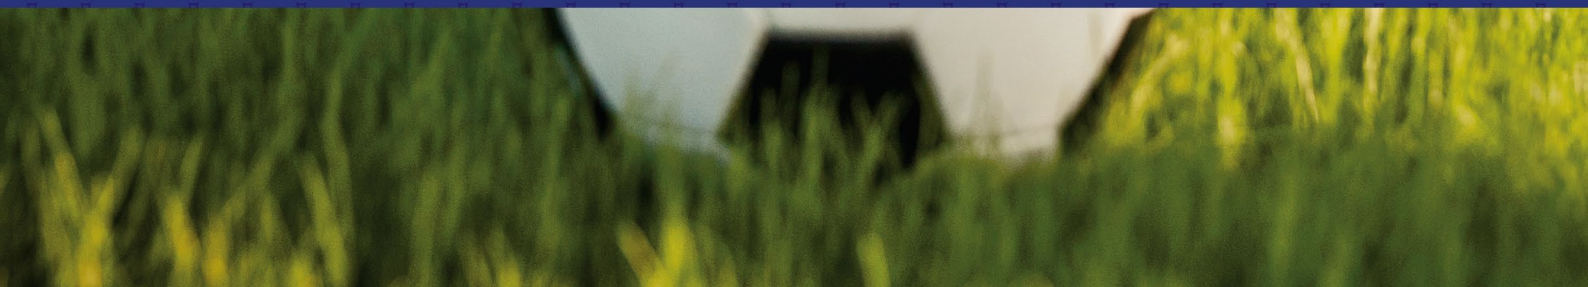

SISTEMA PER LA GESTIONE INSULINICA OMNIPOD®

INTRODUZIONE **2**

Che cos'è il sistema Omnipod®? 2

Il Pod 3

Il Personal Diabetes Manager (PDM) 4

VANTAGGI DEL SISTEMA OMNIPOD® **5**

Flessibilità senza tubi 5

Discreto, indossabile e impermeabile* 6

Erogazione continua di insulina 7

Facile da attivare 8

Semplice da programmare 9

Impostazioni e opzioni del sistema PDM 10

Competenze per il training prima di iniziare ad utilizzare il Pod 11

Competenze per training inizio soluzione salina/insulina 12

Follow-up competenze per il training 14

Guida alle impostazioni per la terapia con il Pod 15

TEAM DI ASSISTENZA CLIENTI THERAS **18**

*Il Pod è garantito da un grado di impermeabilità IPX8 fino a 7,6 metri e fino a un massimo di 60 minuti. Il PDM non è impermeabile.

CHE COS'È IL SISTEMA OMNIPOD®?

Il sistema Omnipod® è un microinfusore per insulina impermeabile* e privo di tubi per le persone affette da diabete dipendente da insulina.

È costituito solo da due elementi principali: il Pod senza tubi e il palmare Personal Diabetes Manager (PDM) da tenere a portata di mano per programmare l'erogazione dell'insulina in modalità wireless**.

+ Il Pod privo di tubi è piccolo, leggero e impermeabile* ed è in grado di fornire fino a 3 giorni di somministrazione continua di insulina***
+ La cannula, piccola e flessibile, si inserisce automaticamente, iniziando la somministrazione precisa[1] e personalizzata di insulina, controllata e gestita tramite il PDM
+ Il PDM contiene anche un pratico glucometro FreeStyle integrato

Il sistema Omnipod® consente di semplificare la somministrazione di insulina, in modo che il paziente possa svolgere liberamente le attività quotidiane e gestire il diabete di conseguenza. Assicura **la massima semplicità con solo due componenti principali**.

Glooko® + diasend® consente ai pazienti di accedere a tutte le informazioni che riguardano il loro diabete da un'unica piattaforma semplice e intuitiva e di condividere facilmente i dati con te, assicurando così **la massima tranquillità per te e per i pazienti stessi**.

*Il Pod è garantito da un grado di impermeabilità IPX8 fino a 7,6 metri e fino a un massimo di 60 minuti. Il PDM non è impermeabile.
**All'avvio, il PDM e il Pod devono trovarsi uno accanto all'altro e devono toccarsi (possono trovarsi sia nel vassoio che fuori dal vassoio) per garantire una corretta comunicazione durante la fase di priming. Mantenere una distanza entro 1,5 metri durante il normale funzionamento.
***Fino a 72 ore di somministrazione continua di insulina.

Le schermate del PDM possono variare a seconda delle impostazioni dell'utente e del paese.

FreeStyle e i marchi correlati sono marchi commerciali di Abbott Diabetes Care Inc. in varie giurisdizioni e sono utilizzati previa autorizzazione.

Glooko® e diasend® sono marchi commerciali di Glooko Inc. e sono utilizzati previa autorizzazione.

1. Zisser H et al. Novel methodology to determine the accuracy of the OmniPod insulin pump: a key component of the artificial pancreas system. J Diabetes Sci Technol. 2011;5(6):1509-18

IL POD

Un Pod piccolo, leggero e privo di tubi in grado di fornire fino a 3 giorni di somministrazione continua di insulina*.

Applicabile ovunque sia possibile praticare un'iniezione di insulina, la cannula, piccola e flessibile, si inserisce automaticamente con la semplice pressione di un pulsante, avviando la somministrazione precisa[1] e personalizzata di insulina.

Inoltre, a differenza dei microinfusori per insulina con tubi, il Pod può essere indossato discretamente sotto gli indumenti ed è impermeabile**, il che significa maggiore libertà per il paziente.

DIMENSIONI EFFETTIVE DEL POD

Dimensioni

Larghezza: 3,9 cm

Lunghezza: 5,2 cm

Altezza: 1,45 cm

Peso

25 grammi senza insulina

CARATTERISTICHE:

+ Serbatoio di insulina da 200 unità, set di infusione angolato, sistema di inserimento automatizzato, meccanismo di erogazione e alimentatore
+ Il peso è di 25 g con serbatoio vuoto
+ Inserimento automatico della cannula alla sola pressione di un pulsante
+ Finestrella nell'inserto scorrevole rosa per verificare che la cannula sia stata inserita
+ Adesivo resistente
+ Involucro esterno resistente e impermeabile**

SPECIFICHE:

+ Dimensioni: 3,9 × 5,2 × 1,45 cm
+ Peso: 25 g senza insulina
+ Volume serbatoio di insulina: 200 unità
+ Profondità di inserimento della cannula: 6,5 mm
+ Grado di impermeabilità IPX8: 7,6 metri fino a un massimo di 60 minuti**
+ Temperatura di funzionamento: 4,4 - 40 °C
+ Scadenza: 72 ore*

* Fino a 72 ore di somministrazione continua di insulina.
**Il Pod è garantito da un grado di impermeabilità IPX8 fino a 7,6 metri e fino a un massimo di 60 minuti. Il PDM non è impermeabile.

1. Zisser H et al. Novel methodology to determine the accuracy of the OmniPod insulin pump: a key component of the artificial pancreas system. J Diabetes Sci Technol. 2011;5(6):1509-18

IL PDM

Un palmare Personal Diabetes Manager (PDM) remoto e wireless* che controlla la somministrazione di insulina ed è programmato in base alle esigenze specifiche dei pazienti.

Il pratico glucometro FreeStyle® integrato consente ai pazienti di controllare il livello glicemico tutte le volte che serve.

Accedi ai dati del PDM dei pazienti tramite Glooko + diasend® per fornire raccomandazioni di trattamento aggiornate.

Caratteristiche:

+ Glucometro FreeStyle integrato
+ Ampio display a colori con modalità di massima illuminazione
+ Schermata ID personalizzabile
+ Luce del foro per la striscia reattiva per condizioni di scarsa illuminazione
+ Suggeritore del bolo consigliato (calcola anche l'insulina attiva)
+ Mini porta USB per scaricare i registri memorizzati in report e grafici chiari e intuitivi
+ Pratici suggerimenti, come ad esempio "Mangi adesso?"

Specifiche:

+ Dimensioni: 6,2 × 11,3 × 2,5 cm
+ Peso: 125 grammi
+ Display: 3,6 × 4,8 cm
+ Batteria: 2 batterie alcaline AAA
+ Intervallo: fino a 1,5 m durante il normale funzionamento
+ Garanzia: 4 anni

*All'avvio, il PDM e il Pod devono trovarsi uno accanto all'altro e devono toccarsi (possono trovarsi sia nel vassoio che fuori dal vassoio) per garantire una corretta comunicazione durante la fase di priming. Mantenere una distanza entro 1,5 metri durante il normale funzionamento.

Le schermate del PDM possono variare a seconda delle impostazioni dell'utente e del paese.

FreeStyle e i marchi correlati sono marchi commerciali di Abbott Diabetes Care Inc. in varie giurisdizioni e sono utilizzati previa autorizzazione.

Glooko® e diasend® sono marchi commerciali di Glooko Inc. e sono utilizzati previa autorizzazione.

FLESSIBILITÀ SENZA TUBI

Senza tubi significa meno parti rispetto ai microinfusori per insulina con tubi. Il Pod contiene ed eroga l'insulina, senza doversi preoccupare di tubicini fastidiosi.

SISTEMA OMNIPOD® RISPETTO A **MICROINFUSORI TRADIZIONALI CON TUBI**

Il Pod può essere indossato ovunque sia possibile praticare un'iniezione di insulina, e senza i tubi e le limitazioni imposte dai microinfusori per insulina con tubi, il paziente ha più libertà di muoversi, giocare, praticare sport, nuotare*, dormire, vivere l'intimità e godersi appieno la propria vita.

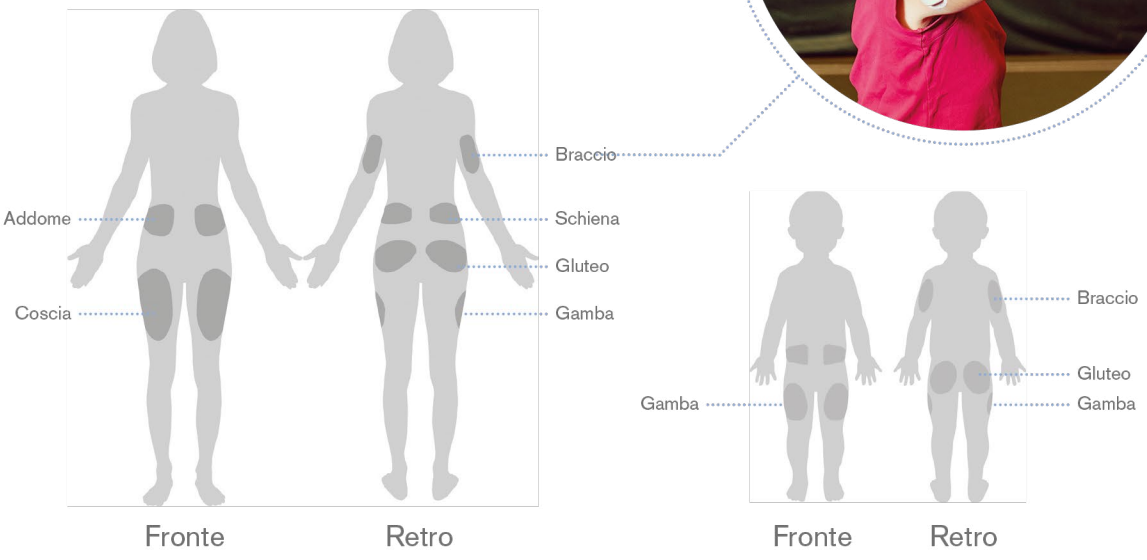

*Il Pod è garantito da un grado di impermeabilità IPX8 fino a 7,6 metri e fino a un massimo di 60 minuti. Il PDM non è impermeabile.

DISCRETO, INDOSSABILE E IMPERMEABILE*

Il Pod è piccolo, leggero e discreto. Non è necessario che il paziente scelga indumenti in grado di contenere un ingombrante microinfusore per insulina con tubi o di nascondere i tubi.

Inoltre, il Pod è impermeabile*. Può essere indossato per fare la doccia, il bagno o per nuotare, senza interrompere la somministrazione dell'insulina.

*Il Pod è garantito da un grado di impermeabilità IPX8 fino a 7,6 metri e fino a un massimo di 60 minuti. Il PDM non è impermeabile.

EROGAZIONE CONTINUA DI INSULINA

Anche una breve interruzione dell'erogazione di insulina può causare un aumento del livello glicemico, che può rimanere elevato per ore dopo l'interruzione.[2]

Poiché il Pod è applicato direttamente sul corpo ed è impermeabile*, non deve essere rimosso per fare la doccia, praticare sport o nei momenti di intimità. A differenza dei microinfusori per insulina tradizionali, non è necessario scollegarlo, pertanto si può essere certi che l'erogazione di insulina è veramente continua.

Uno studio prospettico, in aperto, pubblicato su Diabetes Care, ha misurato l'impatto sui livelli glicemici di scollegamenti per brevi periodi del set di infusione. Conclusione: "un'interruzione di 30 minuti dell'infusione di insulina basale ha provocato un aumento significativo della glicemia; è stato interrotto ~1 mg/dL per ogni minuto di infusione di insulina basale".[2]

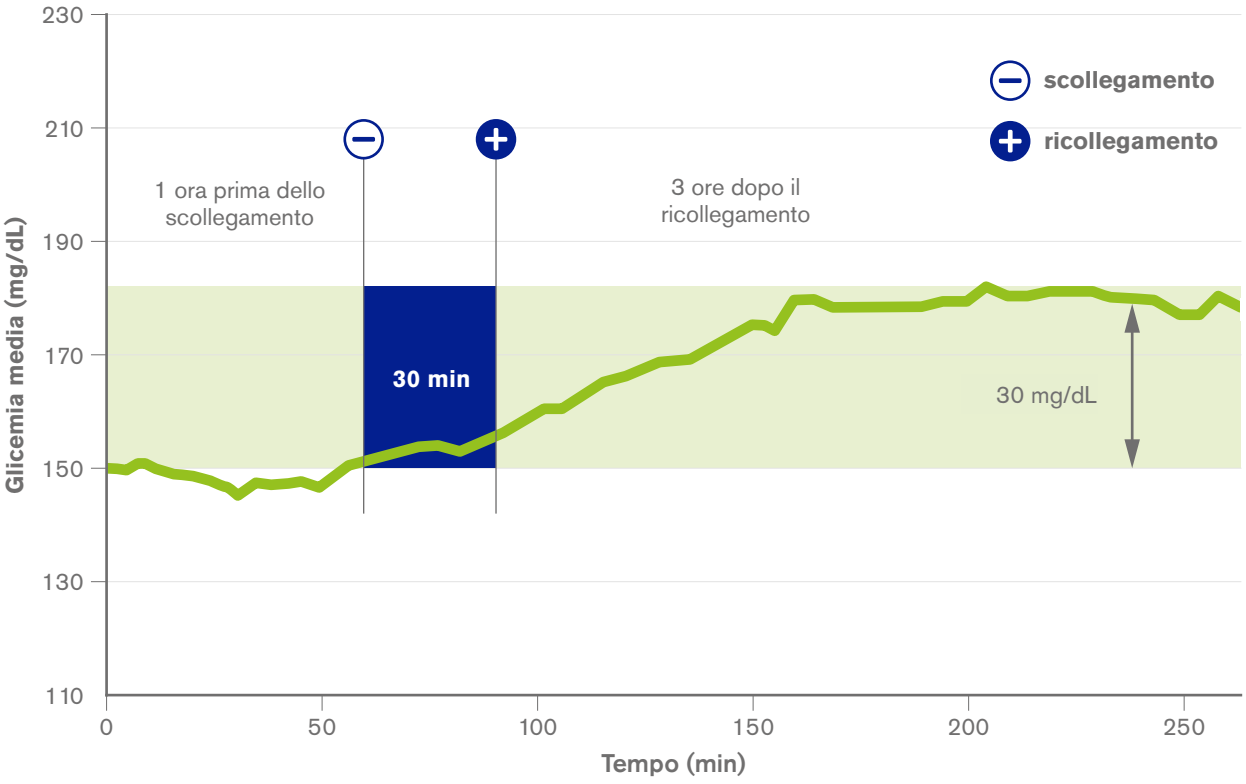

*Il Pod è garantito da un grado di impermeabilità IPX8 fino a 7,6 metri e fino a un massimo di 60 minuti. Il PDM non è impermeabile.

2. Zisser H. Quantifying the Impact of a Short-Interval Interruption of Insulin-Pump Infusion Sets on Glycemic Excursions. Diabetes Care. 2008; 31:238-239

FACILE DA ATTIVARE

Il Pod è facile da impostare. Una volta che il Pod è pieno, il priming viene avviato automaticamente. La cannula viene attivata per l'inserimento premendo un tasto sul PDM.

Passaggio 1. Riempire il Pod

Il Pod effettua il priming automatico ed esegue una serie di controlli di sicurezza per preparare l'erogazione dell'insulina.

Passaggio 2. Applicare il Pod

Il Pod può essere indossato ovunque il paziente praticherebbe un'iniezione. Un resistente adesivo fa aderire saldamente il Pod sulla pelle.

Passaggio 3. Premere Avvia sul PDM

La cannula si inserisce automaticamente a un angolo e a una profondità costanti. La somministrazione di insulina inizia senza dover vedere o toccare l'ago di inserimento.

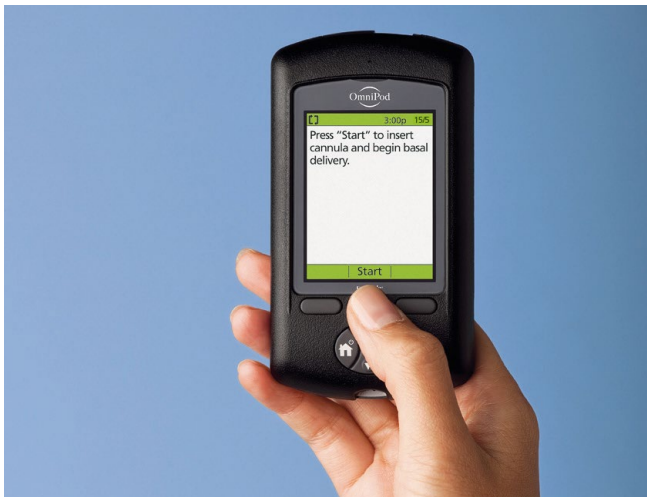

Le schermate del PDM possono variare a seconda delle impostazioni dell'utente e del paese.

FreeStyle e i marchi correlati sono marchi commerciali di Abbott Diabetes Care Inc. in varie giurisdizioni e sono utilizzati previa autorizzazione.

SEMPLICE DA PROGRAMMARE

Il Pod e il Personal Diabetes Manager (PDM) comunicano in modalità wireless* per l'erogazione continua di insulina.

IL PDM

IL POD

Il PDM fornisce istruzioni chiare, semplici da seguire e dettagliate su come impostare il Pod e programmare la somministrazione personalizzata dell'insulina.

Ciò significa che è possibile dedicare meno tempo agli aspetti tecnici e più tempo alla gestione del diabete del paziente.

Il PDM programma in remoto la somministrazione personalizzata dell'insulina in base alle velocità impostate e alle variabili consigliate al paziente nel piano di gestione del diabete. È dotato di un glucometro FreeStyle integrato e di un suggeritore del bolo consigliato per somministrare una dose precisa di bolo. Il suggeritore utilizza i valori di glicemia correnti, i carboidrati inseriti e l'insulina attiva per determinare la dose di bolo consigliata.

*All'avvio, il PDM e il Pod devono trovarsi uno accanto all'altro e devono toccarsi (possono trovarsi sia nel vassoio che fuori dal vassoio) per garantire una corretta comunicazione durante la fase di priming. Mantenere una distanza di almeno 1,5 metri durante il normale funzionamento.

FreeStyle e i marchi correlati sono marchi commerciali di Abbott Diabetes Care Inc. in varie giurisdizioni e sono utilizzati previa autorizzazione.

IMPOSTAZIONI E OPZIONI DEL SISTEMA PDM

Bolo	+ Incrementi: 0,05/0,1/0,5/1,0 U + Bolo massimo: 30 U + Portata bolo massimo: 1,5 U/min + Bolo prolungato: % o U
Basale	+ 7 programmi basale + 24 segmenti in incrementi di 30 minuti + Velocità basale max.: 30 U/ora + Incremento velocità basale: 0,05 U/ora + Basale temporanea: % o U
Suggeritore di bolo	+ Insulina attiva (IOB) + 8 segmenti per il valore del target glicemico + 8 segmenti per il rapporto insulina/carboidrati + 8 segmenti per il fattore di correzione
Preimpostazioni	+ 7 per bolo + 36 per carboidrati + 7 per basale temporanea
Memoria	+ Fino a 5400 registrazioni (90 giorni di dati)
Glucometro	+ Glucometro FreeStyle integrato + Calibrazione: plasma-equivalente + Campione: sangue intero, capillare + Dimensioni del campione: 0,3 µl + Durata del test: 7 secondi

FreeStyle e i marchi correlati sono marchi commerciali di Abbott Diabetes Care Inc. in varie giurisdizioni e sono utilizzati previa autorizzazione.

COMPETENZE PER IL TRAINING PRIMA DI INIZIARE A UTILIZZARE IL POD

Valutazione paziente suggerita

+ Ottenere la storia clinica del diabete rilevante:
  - Tipo di diabete e durata
  - Complicanze
  - Farmaci per il diabete
+ Valutare la comprensione degli argomenti per l'autogestione del diabete:
  - Regime di insulina
  - Test per la glicemia e/o monitoraggio continuo del glucosio (CGM)
  - Terapia nutrizionale medica

Argomenti suggeriti per la gestione del diabete

+ Istruzioni per il conteggio dei carboidrati
+ Auto-monitoraggio della glicemia (frequenza, registro)
+ Sintomi e trattamento per l'ipoglicemia
+ Sintomi e trattamento per l'iperglicemia
  - Chetoni, chetoacidosi diabetica (DKA), materiali per test dei chetoni
+ Malattia e attività fisica imprevista

Argomenti suggeriti per la terapia con microinfusore di insulina

+ Definire le differenze nella terapia di transizione
+ Definire la velocità basale e le dosi di bolo
+ Segmenti e programmi basali
+ Velocità basali temporanee
+ Calcoli del bolo consigliato
  - Insulina attiva (IOB)
  - Rapporto insulina/carboidrati (IC)
  - Fattore di correzione

Argomenti suggeriti per il sistema Omnipod®

+ Panoramica sul sistema
  - Personal Diabetes Manager (PDM)
    - Funzione e disposizione pulsanti
    - Batterie (2 alcaline AAA)
    - Monitoraggio glicemia integrato
    - Distanze di comunicazione
    - Download dei dati
  - Pod
    - Opzioni di posizionamento
    - Rotazione del sito
    - Impermeabile (grado di impermeabilità IPX8)
+ Assistenza clienti, assistenza e riordino

COMPETENZE PER TRAINING INIZIO SOLUZIONE SALINA/INSULINA

Materiali di consumo per il training

+ Pod
+ PDM (Personal Diabetes Manager)
+ Soluzione salina o insulina/tampone imbevuto di alcool
+ Strisce/lancette FreeStyle
+ Dispositivo a lancetta/soluzione di controllo
+ 2 batterie alcaline AAA

Panoramica del sistema Omnipod®

+ Processo di comunicazione, distanza, errori
+ Stato non disponibile, icona RF

Panoramica del Pod

+ Impermeabile (IPX8) 7,6 metri per 60 minuti
+ Indossabile fino a 3 giorni
+ Linee guida per la conservazione

Personal Diabetes Manager (PDM)*

+ 2 batterie alcaline AAA
+ Revisione disposizione pulsanti
+ Configurazione guidata
+ Impostazioni/caratteristiche riesaminate
+ Timeout schermo/retroilluminazione

Schermata Home/menu

+ Bolo
  - Bolo di correzione
  - Bolo pasto
  - Bolo prolungato
  - Conferma/erogazione
  - Annullamento bolo

Altre azioni/Attivazione Pod

+ Sostituire Pod
  - Istruzioni visualizzate sul display; *seguirle esattamente*
  - Pod e insulina a temperatura ambiente
  - Riempire la siringa - Discutere quantità max./min.
+ Foro di riempimento/cappuccio dell'ago
+ Priming automatico
+ Per il priming: posizionare il Pod fianco a fianco e a contatto con il PDM
+ Scelta sito/rotazione
+ Preparazione sito
+ Inserimento automatico cannula
  - Controllare sito di infusione/cannula/finestrella di visualizzazione
  - Inserto scorrevole rosa
  - Controllare la glicemia 1,5 - 2 ore dopo l'inserimento
+ Vibrazione
+ Velocità basali temporanee
  - Aumento/riduzione
  - 2 segnali acustici ogni 30 min.
+ Miei registri
  - Insulina, glicemia, allarme, carboidrati
  - Cronologia generale
  - Funzionalità evento/giorno
  - Scaricare il programma
+ Sospendere/Riprendere/Annullare
  - Tutti in base al tempo di erogazione
  - Velocità temporanea - Impostazione e annullamento
  - Bolo prolungato - Annullamento
  - Impostazioni
  - Programmi basale
    - Modifica basale 1: nome personalizzato
    - Aggiungi nuovo/modifica preimpostazioni
    - Basale temporanea preimpostata
    - Bolo preimpostato/carboidrati preimpostati
    - Impostazione del sistema
    - Cambia/Modifica impostazioni

*Questa Guida alle risorse è per i modelli di PDM ATT400, DET400, DET450, DET456, ENT450, FRT400, FRT456, ITT400 e NLT450.

FreeStyle e i marchi correlati sono marchi commerciali di Abbott Diabetes Care Inc. in varie giurisdizioni e sono utilizzati previa autorizzazione.

Monitoraggio glicemia

+ Glucometro FreeStyle integrato
+ Code predefinito 16
+ Striscia per test FreeStyle
+ Prescrizione
+ Immissione manuale glicemia
+ Luce foro per striscia reattiva
+ Tag glicemici

Schermate Stato

+ Schermata ID
+ Durata batteria
+ Volume rimanente
+ Data/ora
+ Ultima glicemia/ultimo bolo
+ Velocità basale attuale
+ Scadenza del Pod
+ Insulina attiva (IOB)

Avvisi, allarmi e pericoli

+ Istruzioni sul display
+ Promemoria personalizzati
  - Promemoria glicemici
  - Promemoria bolo
  - Scadenza
  - Promemoria programma
  - Promemoria rassicurazione
+ Errori glucometro
+ Segnali di notifica (risposta ai segnali acustici richiesta)
  - Serbatoio quasi vuoto
  - Notifica/avviso di scadenza
  - Fine della sospensione dell'insulina
  - Guida in caso di occlusione del Pod
+ Allarmi di pericolo (richiesta attenzione ai segnali acustici continui)
  - Serbatoio vuoto - Sostituire il Pod adesso
  - Pod scaduto - Sostituire il Pod adesso
  - Occlusione rilevata
  - Spegnimento automatico - Rimuovere il Pod adesso
  - Errori: PDM, Pod, sistema

Altre voci della checklist

+ Risoluzione dei problemi di ipoglicemia e iperglicemia
+ Quando cambiare il Pod
+ Kit di materiali di consumo quotidiani di scorta
+ Revisione Manuale d'uso

FreeStyle e i marchi correlati sono marchi commerciali di Abbott Diabetes Care Inc. in varie giurisdizioni e sono utilizzati previa autorizzazione.

FOLLOW-UP COMPETENZE PER IL TRAINING

Il Pod è garantito da un grado di impermeabilità IPX8 fino a 7,6 metri e fino a un massimo di 60 minuti. Il PDM non è impermeabile.

Argomenti suggeriti per la gestione del diabete

+ Revisione per malattia e attività fisica
+ Auto-monitoraggio della glicemia e/o revisione monitoraggio continuo del glucosio
+ Episodi di ipoglicemia e qualità del trattamento
+ Episodi di iperglicemia e qualità del trattamento
+ Degenza ospedaliera, esami medici e procedure (programmati o esistenti)

Argomenti suggeriti per la terapia con microinfusore di insulina

+ Valutazione velocità basale
+ Valutazione dose del bolo
+ Funzionalità avanzate
  - Basale temporanea
  - Bolo prolungato
  - Programmi basali multipli

Argomenti suggeriti per il sistema Omnipod®

+ Revisione frequenza di sostituzione della batteria del PDM
+ Revisione processo di sostituzione del Pod
+ Revisione scelta sito/rotazione del Pod
+ Revisione download dei dati
+ Revisione risoluzione problemi
+ Assistenza clienti, assistenza e promemoria riordini

GUIDA ALLE IMPOSTAZIONI PER LA TERAPIA CON IL POD

Configurazione guidata

Immettere il nome dell'utente per identificare il PDM e scegliere il colore della schermata ID. Impostare quindi il formato ora, anno, mese, giorno e data.

1. Velocità massima

Immettere la velocità basale massima (fino a 30 unità/ora)

_____ U/ora

2. Basale 1

Immettere la velocità basale con inizio a mezzanotte per avviare il processo di creazione della basale

_____ U/ora

3. Programma basale

Nota: il programma basale può includere un massimo di 24 segmenti.

Segmento temporale		Velocità	Segmento temporale		Velocità
00.00	alle	U/ora	00.00	alle	U/ora
	alle	U/ora		alle	U/ora
	alle	U/ora		alle	U/ora
	alle	U/ora		alle	U/ora
	alle	U/ora		alle	U/ora
	alle	U/ora		alle	U/ora
	alle	U/ora		alle	U/ora
	alle	U/ora		alle	U/ora
	alle	U/ora		alle	U/ora
	alle	U/ora		alle	U/ora

4. Velocità basale temporanea

Impostare la velocità basale temporanea su %, U/ora o Disattivata (**impostazione predefinita = Disattivata**).

☐ % ☐ U/ora ☐ Disattivata

5. Avviso sonoro glicemia

Attivare o disattivare per impostare gli avvisi sonori del glucometro integrato (**impostazione predefinita = Attivati**)

☐ Attivati ☐ Disattivati

6. Limiti obiettivo glicemico

Immettere i limiti inferiore e superiore dell'obiettivo glicemico da utilizzare nella cronologia glicemica. Questa funzione verrà utilizzata per la visualizzazione grafica dei valori della glicemia (non per il calcolo del bolo).

Limite inferiore _____ mg/dL

Limite superiore _____ mg/dL

Configurazione guidata (continua)

7. Calcoli del bolo consigliato

Accendere per consentire al PDM di suggerire i boli in base alle impostazioni individuali sottostanti.
Se il calcolo del bolo consigliato è impostato su Attivato, completare le sezioni da A a F.

☐ Attivato ☐ Disattivato

A. Target glicemico

Immettere il valore del target glicemico con inizio a mezzanotte.
Immettere quindi il valore "correggere verso l'alto" per ridurre un elevato valore di glicemia.

Segmento temporale		Target	Correggere verso l'alto
00.00	alle		mg/dL o mg/dL
	alle		mg/dL o mg/dL
	alle		mg/dL o mg/dL
	alle		mg/dL o mg/dL
	alle		mg/dL o mg/dL
	alle		mg/dL o mg/dL
	alle		mg/dL o mg/dL
	alle		mg/dL o mg/dL

B. Glicemia minima - per calcoli del bolo

Valore al di sotto del quale il sistema non esegue il calcolo suggerito.
Intervallo = incrementi di 50 - 70 mg/dL in 1 mg/dL o 2,8 - 3,9 mmol/L in 1 mmol/L

mg/dL mmol/L

C. Rapporto insulina/carboidrati (IC)

Il rapporto insulina/carboidrati, a partire dalla mezzanotte.

Segmento temporale		1 unità di insulina copre
00.00	alle	g/carb
	alle	g/carb
	alle	g/carb
	alle	g/carb
	alle	g/carb
	alle	g/carb
	alle	g/carb
	alle	g/carb

Configurazione guidata (continua)

D. Fattore di correzione

Immettere il fattore di correzione iniziale:

Segmento temporale			1 unità di insulina riduce la glicemia
00.00	alle		mg/dL
	alle		mg/dL
	alle		mg/dL
	alle		mg/dL
	alle		mg/dL
	alle		mg/dL
	alle		mg/dL
	alle		mg/dL

E. Correzione inversa

Se attivata, il microinfusore suggerisce un bolo pasto ridotto per una glicemia inferiore al valore del target glicemico.
Se disattivata, il sistema non compensa la glicemia al di sotto del valore target. (**impostazione predefinita = Attivata**).

☐ Attivata ☐ Disattivata

F. Durata dell'azione dell'insulina

Durata per la quale l'insulina rimarrà "attiva" nel corpo da un bolo di correzione precedente.
La durata può essere impostata da 2 a 6 ore in incrementi di 0,5 ore.

ore

8. Incremento bolo

Selezionare l'incremento bolo.

☐ 0,05 unità ☐ 0,10 unità ☐ 0,50 unità ☐ 1,00 unità

9. Bolo massimo

Immettere il bolo massimo, fino a 30 unità, in incrementi di 0,10 unità.
(Assicurarsi di prendere in considerazione il pasto più abbondante e una glicemia alta che richiede una correzione)

U

10. Bolo prolungato

Questa funzione consente di somministrare una dose di bolo per un periodo di tempo prolungato.

☐ % ☐ Unità ☐ Disattivata

11. Avviso di serbatoio quasi vuoto

Inserire le unità di insulina rimanenti nel serbatoio in corrispondenza delle quali il PDM emetterà un suono di avviso.
(Intervallo = 10-50 unità)

Unità

12. Avviso di scadenza

Immettere il numero di ore (1-18) in corrispondenza delle quali l'utente desidera essere avvisato prima della scadenza del Pod.

Ore

Team di Assistenza clienti Theras

Il nostro obiettivo è semplificare la vita a te e ai tuoi pazienti. Fai affidamento su di noi: **saremo al tuo fianco in ogni momento**.

Il team di Assistenza clienti Theras è **disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7**, anche quando tu o il tuo paziente siete in viaggio all'estero, per rispondere a qualsiasi domanda o richiesta relativa al sistema Omnipod®.

Se ha bisogno di assistenza tecnica di emergenza o di consigli su come riordinare i Pod, il nostro team di professionisti è a sua disposizione; basta fare una telefonata.

Paese:	Numero di telefono*:	Indirizzo e-mail:
Italia	800 587 270	omnipod@theras-group.com

Visita myomnipod.com

Visita theras-group.com

*Le telefonate possono essere registrate e monitorate ai fini del controllo qualità. Le chiamate ai numeri 800 sono gratuite da rete fissa, mentre possono essere a pagamento dalle altre reti.

NOTE AGGIUNTIVE

SISTEMA PER LA GESTIONE INSULINICA

Theras GROUP
Medical innovation for a better life

800 587 270

Omnipod® è distribuito in esclusiva per l'Italia da :

Theras Lifetech S.r.l.
Viale Matteotti, 19
43039 Salsomaggiore Terme (PR) ITALY
+39 0524 587874
+39 0524 587834

omnipod@theras-group.com

©2018 Insulet International Ltd., Omnipod, il logo Omnipod e Podder sono marchi commerciali o registrati di Insulet Corporation negli Stati Uniti e in altre varie giurisdizioni. Glooko® e diasend® sono marchi commerciali di Glooko Inc. e sono utilizzati previa autorizzazione. FreeStyle e i marchi correlati sono marchi commerciali di Abbott Diabetes Care Inc. in varie giurisdizioni e sono utilizzati previa autorizzazione. Tutti gli altri marchi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari. L'utilizzo di marchi commerciali di terze parti non costituisce approvazione né implica alcuna relazione o altro tipo di affiliazione. Tutti i diritti riservati. INTL-40078-ENG MG/MM AW R1 04/18. 1 King Street, 5th Floor, Hammersmith, London, W6 9HR.